クーデック®エイミーPCA
簡易取扱説明書

設定内容の確認

1 コムタッチをドライブユニットに接続します。

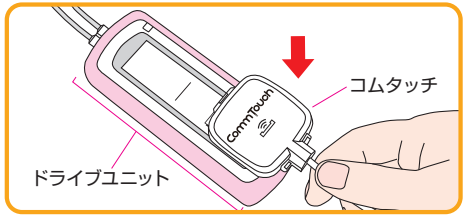

2 設定内容を確認します。

3 コムタッチを取り外します。

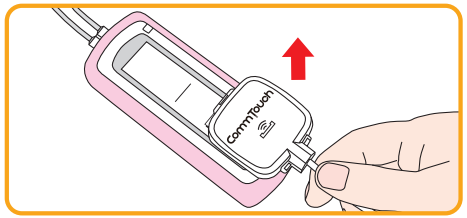

設定内容の変更 ①

1 コムタッチを接続します。

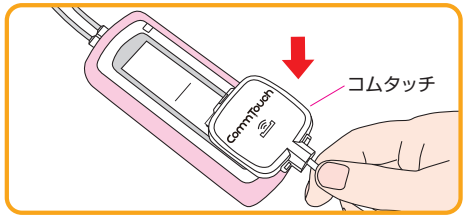

2 輸液を停止します。

3 設定内容の変更を行います。

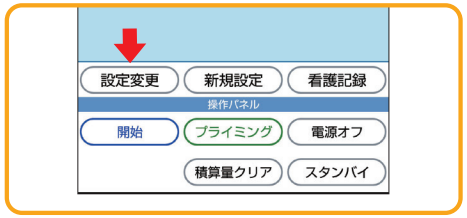

4 ドライブユニットに設定を転送します。

⚠ 注意：取扱説明書及び添付文書をよくお読みいただきご使用ください。

クーデック®エイミーPCA
簡易取扱説明書

設定内容の変更 ②

5 輸液を開始します。

6 コムタッチを取り外します。

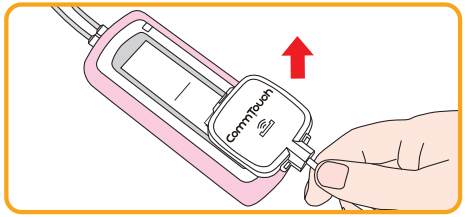

輸液の終了

1 コムタッチを接続します。

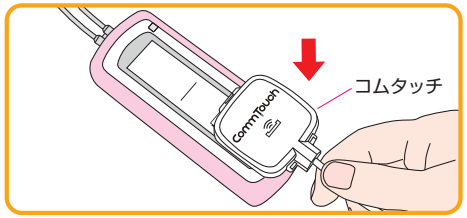

2 輸液を停止します。

3 電源を切ります。

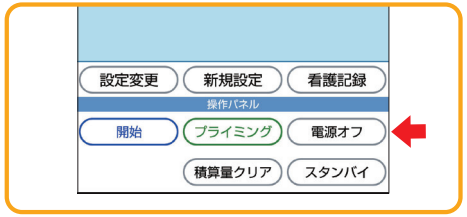

4 コムタッチを取り外します。

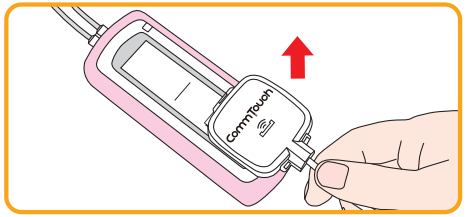

5 ロックを解除します。

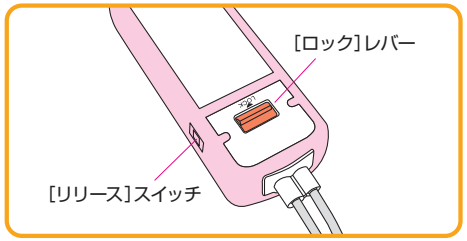

6 ポンプユニットを取り外します。

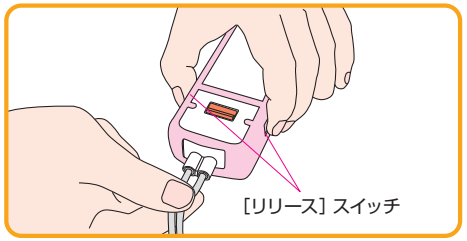

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 汎用輸液ポンプ 輸液ポンプ用輸液セット

医療機器承認番号：30100BZX00245000
販売名：クーデックエイミー

COOPDECH

クーデック®エイミーPCA
トラブル時の対処方法

高優先度アラーム

［警報］ランプは赤色で点滅し、輸液を停止します。

❶閉塞警報（輸液ラインが閉塞したとき）

輸液ラインが閉塞し、閉塞圧検出レベルを超えています。輸液は安全のため停止しています。
輸液ラインを閉じて閉塞の原因を取り除いてください。
閉塞検出圧力は以下の通りです。

設定値	検出圧力
[L]	40±20[kPa]
[M]	70±25[kPa]
[H]	110±30[kPa]
AUTO	流量により自動切替

※ドライブユニットの最大輸液圧力は上記範囲内となります。

❷気泡警報（輸液ラインに気泡が混入したとき）

輸液ライン内に気泡が混入しているか、バッグの薬液がなくなっています。輸液は安全のために停止しています。輸液ラインを患者から取り外し、プライミングしてください。
※バッグの薬液がなくなっている場合は、エイミーMPユニットを交換してください。
※薬液が流れない状態が長時間維持された場合、輸液ライン内に気泡がたまり、警報が発生するおそれがあります。

❸完了警報（積算量が予定量に到達したとき）

積算量が予定量に達しています。輸液は安全のために停止しています。輸液を終了する場合は、［電源オフ］を押して電源を切ってください。輸液を継続する場合は、積算量をクリアするか、予定量を追加してください。
KVO（キープベインオープン）設定時は、KVO時の流量で輸液を継続しています。
※KVO（キープベインオープン）：予定量完了後、輸液ライン内の薬液固着による閉塞防止のため、低流量で送液します。工場出荷時設定は、KVO機能はオフです。



❹ポンプ異常警報（ポンプに異常が発生したとき）

ポンプユニットに何らかの異常が発生しています。異常の原因は以下の要因となります。

- ポンプユニットの故障
- ポンプユニットの接続異常
- ポンプユニットへの出力異常

輸液は安全のため停止しています。
ポンプの接続を確認してください。又はエイミーMPユニットを交換してください。

❺シャットダウン警報（バッテリ残量がなくなったとき）

バッテリの残量がありません。輸液は安全のために停止しています。エイミーズホームで充電してください。
※シャットダウン警報は充電を始めるまで消音できません。
　充電しない場合約3分後に電源が切れます。
※電源オフにすると設定がクリアされます。
※シャットダウン警報中に充電を開始した場合は、シャットダウン警報発生前の状態に戻ります。

医療社会を未来する——
大研医器株式会社
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます。
http://www.daiken-iki.co.jp/

［製品に関するお問い合わせ窓口］
大研医器株式会社 カスタマーセンター
フリーダイヤル 0120-233-036
受付：月～金 9:00～17:00（祝日、弊社休日は除く）
TEL 0725-51-2138

クーデック®エイミーPCA
トラブル時の対処方法

低優先度アラーム

［警報］は橙色で点灯します
※高優先度アラーム中は、低優先度アラームが発生しません。
※低優先度アラーム中に高優先度アラームが発生した場合は高優先度アラームが優先されます。

❶操作忘れ警報（一定時間操作していないとき）

ポンプユニットが装着された状態で一定時間（3 分）操作していません（工場出荷時設定）。
設定内容を確認して輸液を開始するか、スタンバイモードにしてください。
※スタンバイモード時は輸液開始忘れに注意してください。

❷完了前警報
（プログラム投与の際、輸液完了が近付いたとき）

プログラム投与の完了が近付いています。継続する場合は薬液の準備を行ってください。

❸ポンプロック検出警報
（輸液中に［ロック］レバーのロックが解除されたとき）

［ロック］レバーのロックが解除されました。ロックしてください。

❹バッテリ残量警報（バッテリ残量が少なくなってきたとき）

バッテリ残量が30分未満です。エイミーズホームで充電してください。

エラーコード一覧

エラーコード	要因
1	バッテリ電圧異常
2	音声電源異常
3	給電電圧異常
4	赤外線通信異常
6	バッテリ管理回路異常
7	音声回路異常
8	衝撃回路異常
9	ポンプ駆動電圧異常
10	閉塞センサ異常

エラーコード	要因
11	温度センサ異常
14	ワイヤレス回路異常
15	機器設定値異常
16	制御回路異常 ※強い衝撃を受けた場合等に発生する可能性があります。通常使用時に繰り返し発生する場合は機器の故障が考えられます。

※エラーコードが出た場合は、
弊社担当者まで連絡してください。

2503B＜社内管理番号：08604562-J02＞